

# KOBAN



EG000044

EC000499

Comprobador del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento de los quirófanos. Este equipo solo puede ser utilizado en instalaciones IT en locales destinados a uso médico. Para utilizar el equipo solo se necesita un equipo de medida externo. Recomendamos un multímetro o pinza amperimétrica digital de verdadero valor eficaz.



INCLUIDO CERTIFICADO DE  
CALIBRACIÓN  
DE FÁBRICA TRAZABLE




## ESPECIFICACIONES GENERALES

Temperatura de almacenamiento	-10 °C a 70 °C
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Humedad de almacenamiento	<80% humedad relativa
Humedad de funcionamiento	<70% humedad relativa
Peso	449g
Caso	ABS/TPR
Dimensiones	117 x 80 x 32 mm
Categoría de sobrevoltaje	Categoría II 300V
Tensión nominal del sistema	230V AC
Escala de resistencia de aislamiento de prueba ajustable	33kΩ a 225kΩ
Resistencia de detección de corriente	1KΩ (±3%)




- ✓ EN-61010-1
- ✓ EN 61557
- ✓ EN 60364

## MEDICIÓN RESISTENCIA AISLAMIENTO SUELO Y PARED

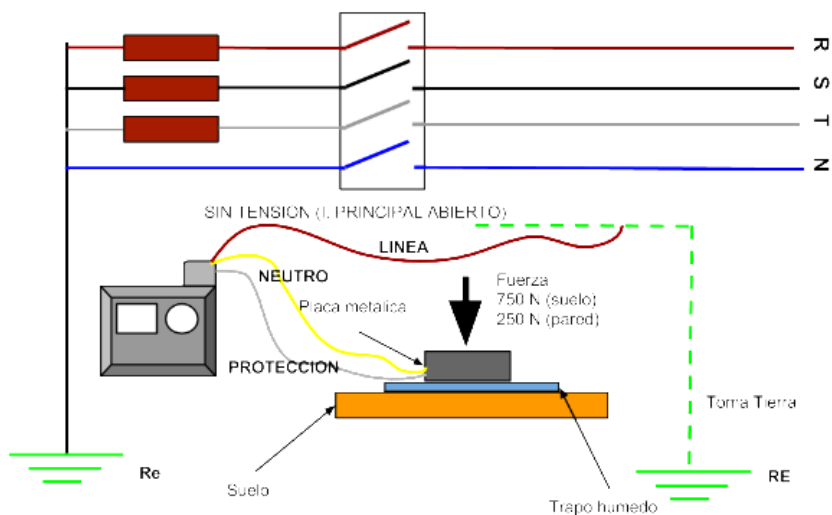

## ESQUEMA DE SISTEMA IT PARA SU COMPROBACIÓN

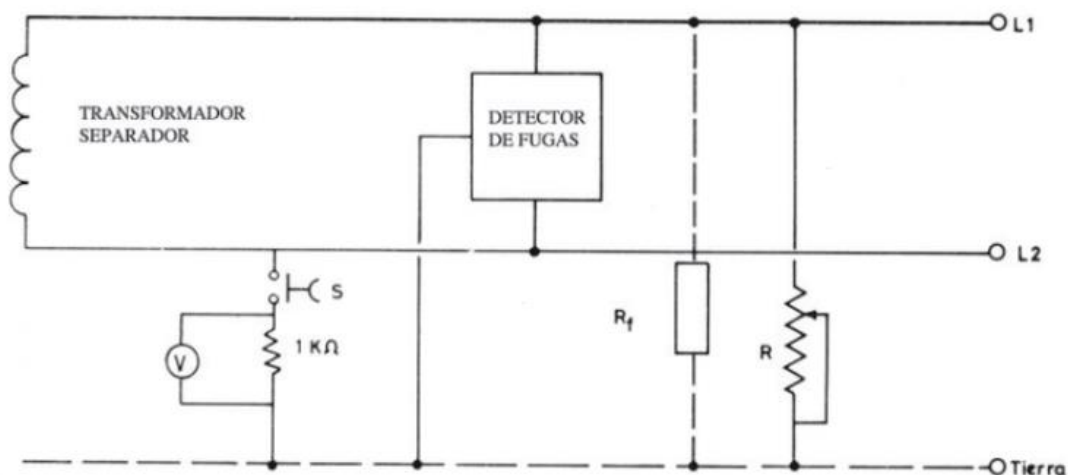

Toma de corriente del sistema IT

